

# 臺南市關廟區五甲國民小學暫停實體課程3天通知單

各位師長、家長您好，貴班暫停實體課程通告：

- 一、依據臺南市所屬因應 COVID-19 實施暫停實體課程(05/08 公佈)。
- 二、新增暫停實體課程班級停課時間：05/22 (日) 下午五點左右接獲相關的通知。
  - **四年丙班** 暫停實體課程 **05/22(日) ~ 05/24(二)** 星期三05/25(三)復課。

敬請家長也不要讓學生到安親班，本校會針對該教室環境清消作業，懇請**等候通知再到校領取快篩試劑**，**P.S 返校前進行快篩陰性後**，請將快篩陰性結果告知導師，再來學校恢復實體上課，並會依據最新規定進行滾動式修正，再另行通知，敬請家長協助與配合。

三、暫停實體課程說明：

1. 暫停實體課程期間「停課不停學」，教職員工除經須通報需要隔離外，均須正常上班，故請老師依照原定課程上課，以「同步、非同步」混成方式進行線上教學。線上教學屬於正式課程，暑假期間不另行補課。
  2. 因改採居家線上教學，本校已彙整建置線上學習資源，五甲國小線上自主學習區 (<https://www.wjes.tn.edu.tw/index.php>)，請依照導師以及各科任老師安排，按課表作息上課，若有相關問題請與該班導師聯繫、或打電話到教務處洽詢。
- 四、但仍請家長們在接下來的這個星期注意小朋友的身體狀況，若發現學童或自己身體有異常，請依規定自主健康管理「不到校、速通報」，以確保更多孩子的校園安全與健康。敬請大家一起來做好防疫工作，讓我們一起共同防疫、守護五甲、守護臺南。 敬祝各位身體健康平安！

敬祝 平安健康

臺南市關廟區五甲國民小學 111年 05 月 22 日

五甲國小電話：06-5952155 分機：教務處302、學務處303、總務處304、輔導室305

臺南市所屬學校因應 COVID-19

## 新校園防疫措施

(111.05.08起新制)

- ① 取消原全校停課規定，惟學校得考量運作量能自主應變並報教育局備查。
- ② 居家隔離對象僅限同住親友，住宿生同寢室室友比照辦理。
- ③ 5/7前已停課的班級/個人，依學校原規定辦理；5/8起適用新制。
- ④ 快篩陽性得比照確診個案進行預防性停課。

確診者 學習階段	國小及幼兒園 安親班、課照班比照	國高中生 補習班比照	假別
<b>自主應變</b> <b>停課對象</b> 確診前2日曾接觸	<b>同班同學 與 導師</b>	<b>班級座位 九宮格同學</b>	<b>學生</b> 不列入出缺勤紀錄。
<b>防疫應變</b>	<b>課程、社團、活動、交通車</b> 摘下口罩共同活動15分鐘以上者		<b>老師</b> 【確診】公假 【居家隔離】防疫隔離假
	① 防疫假3日不到校，期滿快篩陰性後返校。 ② 學校提供師生1人1劑快篩試劑。		<b>家長</b> 可申請防疫照顧假

上述標準依中央規定及本市疫情發展滾動修正  
臺南市政府教育局 關心您 111.05.08

# 自5/8起 國小及幼兒園

確診個案前2日內曾到校上課  
所屬班級的同學和老師：


暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑  
快篩試劑

(招收國小以下學童)

▲補習班、安親班與課照中心比照辦理，所需快篩試劑由學校發放，不重複提供

防疫假不列入差勤記錄

**FORA** 靈敏度佳、準確度高的病毒  
快篩試劑  
FORA 靈敏度佳、準確度高的病毒  
快篩試劑  
FORA 靈敏度佳、準確度高的病毒  
快篩試劑

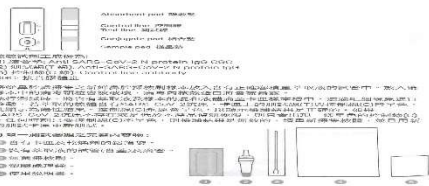

1. 請將快篩試劑取出，並檢查包裝是否完好。
2. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
3. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
4. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
5. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
6. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
7. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
8. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
9. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
10. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
11. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
12. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
13. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
14. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
15. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
16. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
17. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
18. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
19. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
20. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

1. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
2. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
3. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
4. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
5. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
6. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
7. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
8. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
9. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
10. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
11. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
12. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
13. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
14. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
15. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
16. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
17. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
18. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
19. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。
20. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

**注意事項**

1. 請將快篩試劑取出，並檢查包裝是否完好。

2. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

3. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

4. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

5. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

6. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

7. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

8. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

9. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

10. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

11. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

12. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

13. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

14. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

15. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

16. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

17. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

18. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

19. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

20. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

**注意事項**

1. 請將快篩試劑取出，並檢查包裝是否完好。

2. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

3. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

4. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

5. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

6. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

7. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

8. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

9. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

10. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

11. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

12. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

13. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

14. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

15. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

16. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

17. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

18. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

19. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

20. 取出快篩試劑後，請將包裝袋密封，並丟入指定回收箱。

FORA COVID-19 Rapid Test Kit (Self-Test) Instructions for Use


1. Preparation of the test cassette

1. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
2. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
3. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
4. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
5. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
6. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
7. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
8. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
9. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
10. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
11. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
12. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
13. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
14. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
15. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
16. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
17. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
18. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
19. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.
20. Remove the test cassette from the pouch and check the expiration date.

FORA COVID-19 Rapid Test Kit (Self-Test) Instructions for Use

2. Preparation of the control solution

1. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
2. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
3. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
4. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
5. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
6. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
7. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
8. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
9. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
10. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
11. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
12. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
13. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
14. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
15. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
16. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
17. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
18. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
19. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.
20. Remove the control solution from the pouch and check the expiration date.

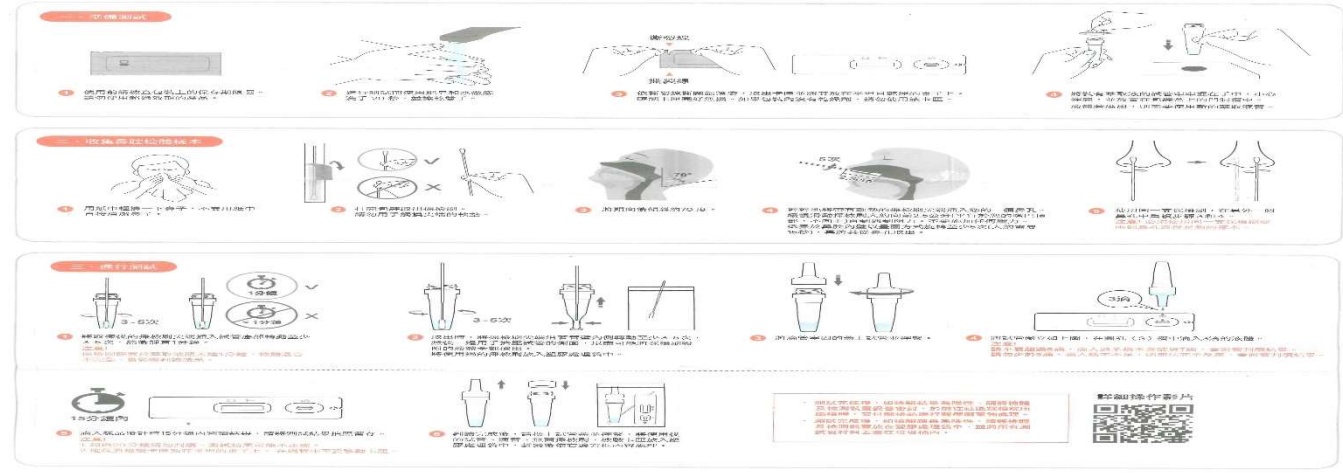

**1 Positive result 陽性結果**

卡上的測試線(T)處出現紅色條帶，無論測試線(C)處是否出現紅色條帶，均為陽性結果。

**2 Negative result 陰性結果**

僅在測試線(C)處出現紅色條帶，而測試線(T)處未出現紅色條帶，為陰性結果。

**3 Invalid result 無效反應**

無任何測試線(C)或(T)處出現紅色條帶，或兩處均出現紅色條帶，均為無效反應。

請重新檢查試劑，並重新進行測試。